



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของ
งานซื้อในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๓,๑๒๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย

(extracorporeal complete set)

จำนวน ๓๔๐ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่
ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ ๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaen.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โปรดสอบถามมายังจังหวัดขอนแก่น ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๙๙๐๐ ต่อ ๓๗๕๐ ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ล


(นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น


ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย (extracorporeal complete set)
โรงพยาบาลขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 - 1.1. ชุดใช้ร่วมกับเครื่องหัวใจและปอดเทียม เป็นทางไหล เข้า-ออก ของเลือดจากระบบปอดและหัวใจเทียม กลับเข้าสู่ร่างกายและเลือดจากร่างกาย ไหลลงสู่ระบบปอดเทียมขณะผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
2. คุณสมบัติทั่วไป
 - 2.1. เป็นสายยางไม่มีกลิ่น และปลอดภัยต่อผู้ป่วยเมื่อใช้งาน
 - 2.2. สามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 100 องศาเซลเซียส และทนความเย็นได้ไม่น้อยกว่า -10 องศาเซลเซียส
 - 2.3. สามารถทนต่อแรงกดทับไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้ว
 - 2.4. ผ่านการทำลายเชื้อโรคเรียบร้อยแล้ว บรรจุภาชนะที่ปราศจากเชื้อ สามารถเปิดใช้งานได้ทันที
3. คุณสมบัติเฉพาะชุดใหญ่
 - 3.1. ชุดสายบนโต๊ะผ่าตัด
 - 3.1.1. สายยางพีวีซีขนาด 1/2 นิ้ว x 3/32 นิ้ว ยาว 75 นิ้ว ปลายสายยางข้างหนึ่งมีฝาคอปิด ปิดสีสีน้ำเงิน ปลายสายยางอีกข้างหนึ่ง เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีขนาด 3/8 นิ้ว x 3/32 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ด้วยข้อต่อตรงขนาด 1/2 นิ้ว x 3/8 นิ้ว มีฝาคอปิด สีแดง จำนวน 1 เส้น
 - 3.1.2. สายยาง พีวีซี ขนาด 3/8 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ยาว 100 นิ้ว (ติดแถบสีน้ำเงินทั้งสองปลายของสายยางโดย ยางโดยให้ห่างจากส่วนปลายของสายยางพีวีซี เป็นระยะ 4 นิ้ว) ปลายทั้งสองด้านมีฝาคอปิดสี น้ำเงิน จำนวน 1 เส้น
 - 3.1.3. สายยางพีวีซี ขนาด 1/4 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ยาว 100 นิ้ว ปลายสองด้านมีฝาคอปิดสีเดียวกันโดย แต่และเส้นมีแถบสีเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งตรงกับสีฝาคอปิด (ติดแถบสีทั้งสองปลายของสายยางโดย ให้ห่างจากส่วนปลายของสายยางพีวีซี เป็นระยะ 4 นิ้ว) สายยางชนิดนี้มีจำนวน 2 เส้น ปลายทั้งสอง ด้านมีฝาคอปิดมีสีขาว และสีเหลือง
 - 3.1.4. สายยางทั้งหมดบรรจุแยกจากกันเป็นสัดส่วนและห่อหุ้มด้วยกระดาษปราศจากเชื้อ 2 ชั้น หรือ ถุงพลาสติกที่ปราศจากเชื้อ
 - 3.2. ชุดสายยางใช้กับเครื่องหัวใจและปอดเทียม
 - 3.2.1. สายยางพีวีซี ขนาด 3/8 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว with luer lock ที่ปิดด้วยจุกพลาสติกหัวเกลียวไม่มีรู ติดแถบสีเหลือง เป็น สัญลักษณ์ห่างจากปลายด้านข้อต่อตรง 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว with luer lock เป็นระยะ 2 นิ้ว ปลาย ทั้งสองด้านมีฝาคอปิด สีเหลืองจำนวน 1 เส้น
 - 3.2.2. สายยางพีวีซีขนาด 1/4 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว with luer lock เป็นระยะ 2 นิ้ว เส้นละสี โดยมีสีขาวและสีน้ำเงิน ปลายทั้งสองด้านมี ฝาคอปิดสีเหลือง จำนวน 2 เส้น


 (นางรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


 (น.ส.นิรมล มารตะตา)
 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกชำนาญการ


 (ว่าที่ ร.ต.วัชร โตเครือดี)
 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

- 3.2.3.สายยางพีวีซีใส ขนาด 1/4 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมกับตัวกรองแก๊ส ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด จำนวน 1 เส้น
- 3.2.4.สายยางพีวีซีใส ขนาด 1/4 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด จำนวน 1 เส้น
- 3.2.5.สายยางพีวีซีใสขนาด 1/2 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับ Y Connector ขนาด 1/4 นิ้ว x 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว ส่วนปลายข้างหนึ่งของ Connector เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใสขนาด 3/8 นิ้ว x 3/32 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว ส่วนปลายทั้งหมดที่มีฝาครอบปิด จำนวน 1 เส้น
- 3.2.6.สายยางพีวีซีใส ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/32 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด จำนวน 1 เส้น
- 3.2.7.สายยางพีวีซีใส ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/32 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว with luer lock โดยส่วน luer lock จะเชื่อมต่อหัวเกลียวพลาสติกที่ยึดตรึงกับสายยางพีวีซีใสข้างหนึ่ง ขนาด 3/16 นิ้ว x 3/64 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว และสายยางอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับ 3-way stopcock และกระเปาะพลาสติก (Isolator) และส่วนปลายของ Isolator เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด 3/16 นิ้ว x 3/64 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งมีฝาครอบปิด จำนวน 1 เส้น
- 3.2.8.สายยางซิลิโคน ขนาด 1/2 นิ้ว x 3/32 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรง ขนาด 1/2 นิ้ว x 3/8 นิ้ว จำนวน 1 อัน โดยเชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/32 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว และส่วนปลายของสายยางซิลิโคน อีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด 1/2 นิ้ว x 3/8 นิ้ว จำนวน 1 อัน โดยเชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/32 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว ส่วนปลายสายยางพีวีซีทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด จำนวน 1 เส้น


4. คุณสมบัติเฉพาะชุดเด็ก และทารก

4.1. ชุดสายยางบนโต๊ะผ่าตัด

- 4.1.1.สายยางพีวีซีใส ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/32 นิ้ว ยาว 120 นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดจำนวน 1 เส้น สำหรับใช้กับผู้ป่วยเด็กที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
- 4.1.2.สายยางพีวีซีใส ขนาด 1/4 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ยาว 120 นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดจำนวน 1 เส้น สำหรับใช้กับผู้ป่วยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี
- 4.1.3.สายยางพีวีซีใส ขนาด 1/4 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ยาว 100 ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดสีเดียวกัน โดยแต่ละเส้นมีแถบสีเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งตรงกับสีฝาครอบปิด (ติดแถบสีทั้งสองปลายของสายยางโดยให้ห่างจากส่วนปลายของสายยางพีวีซีใส เป็นระยะ 4 นิ้ว) สายยางชนิดนี้มีจำนวน 3 เส้น มีฝาครอบปิด สีขาว สีเหลือง และสีน้ำเงิน
- 4.1.4.สายยางทั้งหมดบรรจุแยกจากกันเป็นสัดส่วนและห่อหุ้มด้วยกระดาษปราศจากเชื้อ 2 ชั้น หรือถุงพลาสติกที่ปราศจากเชื้อ

4.2. ชุดสายยางใช้กับเครื่องหัวใจและปอดเทียม

- 4.2.1.สายยางพีวีซีใส ขนาด 1/4 นิ้ว x 1/16 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว จำนวน 3 เส้น ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว with luer lock ที่ปิดด้วยจุกพลาสติกหัวเกลียว ไม่มีรู ติดแถบสีเป็นสัญลักษณ์ ห่างจากปลายด้านข้อต่อตรงขนาด 1/4 นิ้ว x 1/4 นิ้ว with luer lock เป็นระยะ 2 นิ้ว เส้นละสี โดยมี สีขาว สีเหลือง และน้ำเงิน ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดสีเหลือง



(นางรักผืน สวัสดิ์พาณิชย์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(น.ส.นิรมล มาระดา)

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกชำนาญการ




(ว่าที่ ร.ต.วัชรเวทย์ โตเครือดี)

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

- 4.2.2.สายยางพีวีซีใส ขนาด $1/4$ นิ้ว $\times$ $1/16$ นิ้ว ยาว 40 นิ้ว สายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับตัวกรองแก๊สปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดจำนวน 1 เส้น
- 4.2.3.สายยางพีวีซีใสขนาด $1/4$ นิ้ว $\times$ $1/16$ นิ้ว ยาว 25 นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด จำนวน 1 เส้น
- 4.2.4.สายยางพีวีซีใส ขนาด $1/4$ นิ้ว $\times$ $1/16$ นิ้ว ยาว 65 นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับ Y Connector ขนาด $1/4$ นิ้ว $\times$ $3/8$ นิ้ว $\times$ $3/8$ นิ้ว ส่วนปลายข้างหนึ่งของ Connector เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด $3/8$ นิ้ว $\times$ $3/32$ นิ้ว ยาว 3 นิ้ว ส่วนปลายทั้งหมดมีฝาครอบปิดจำนวน 1 เส้น
- 4.2.4.1. สายยางพีวีซีใส ขนาด $3/8$ นิ้ว $\times$ $3/32$ นิ้ว ยาว 30 นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิดจำนวน 1 เส้น สำหรับใช้กับผู้ป่วยเด็กที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
- 4.2.5.สายยางพีวีซีใส ขนาด $1/4$ นิ้ว $\times$ $1/16$ นิ้ว ยาว 30 นิ้ว ปลายด้านทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด จำนวน 1 เส้น สำหรับใช้กับผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี
- 4.2.6.สายยางพีวีซีใส ขนาด $3/8$ นิ้ว $\times$ $3/32$ นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงกับขนาด $3/8$ นิ้ว $\times$ $3/8$ นิ้ว with luer lock โดยส่วน luer lock จะเชื่อมต่อกับหัวเกลียวพลาสติก ที่ยึดติดกับสายยางพีวีซีใส ข้างหนึ่ง ขนาด $3/16$ นิ้ว $\times$ $3/64$ นิ้ว ยาว 36 นิ้ว และสายยางอีกข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับ 3-way stopcock และกระเปาะพลาสติก (Isolator) และส่วนปลายของ Isolator เชื่อมต่อกับสายยางพีวีซีใส ขนาด $3/16$ นิ้ว $\times$ $3/64$ นิ้ว ยาว 3 นิ้ว ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งมีฝาครอบปิด จำนวน 1 เส้น
- 4.2.7.สายยางพีวีซีใส ขนาด $3/8$ นิ้ว $\times$ $3/32$ นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ปลายข้างหนึ่งเชื่อมต่อกับข้อต่อตรงขนาด $3/8$ นิ้ว $\times$ $1/4$ นิ้ว สำหรับใช้กับผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
- 4.2.8.สายยางซิลิโคน ขนาด $3/8$ นิ้ว $\times$ $3/32$ นิ้ว ยาว 80 นิ้ว ปลายทั้งสองด้านมีฝาครอบปิด จำนวน 1 เส้น

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. หรือ FDA หรือ CE หรือ ISO
- 5.2. บริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยมีการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์นั้นๆ และผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 5.3. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
- 5.3.1. หากผลิตภัณฑ์หมดอายุหรือใช้ไม่หมดสามารถแลกเปลี่ยนคืนบริษัทโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- 5.3.2. หากบริษัทผู้จำหน่ายมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ผู้ซื้อสามารถขอแลกรุ่นใหม่ล่าสุดได้ และสามารถขอเปลี่ยนขนาดได้ตามที่ผู้ซื้อต้องการ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- 5.4. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานจากที่ไหนมาก่อน
- 5.5. ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ (Sterile pack)



(นางรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(น.ส.นิรมล มารตะตา)
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกชำนาญการ



(ว่าที่ ร.ต.วัชรเวศ โตเครือดี)
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

1. ชื่อบริษัท/ ห้าง/ ร้าน.....
2. ชื่อพัสดุ.....
.....
3. ยี่ห้อ.....
4. รุ่น.....
5. ประเทศ.....
6. กำหนดส่งมอบ.....
7. อื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา
ในวันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....
.....(ชื่อผู้ลงนาม).....
.....(ชื่อธนาคาร).....

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ


.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานก่อสร้างเดิม					
	รายการ....	ลบ.ม.				
	รายการ....	ลบ.ม.				
2	งานผิวทาง					
	รายการ....	ตร.ม.				
	รายการ....	ตร.ม.				
รวม					-	0%

Money									
AccMoney									
% PLAN									
% ACC PLAN									
% ACTUAL									
% ACC ACTUAL									
% ACC DIFF									
% PLAN/2									
% PLAN/2 DIFF									

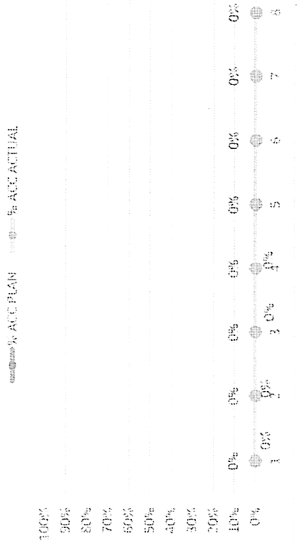

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย (extracorporeal complete set) จำนวน 340 ชุด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 873,120.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 8 มกราคม 2569
เป็นเงิน 873,120.-บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 2,568.-บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 - 5.2 บริษัท เมดิทอป จำกัด
 - 5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นางรักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - 6.2 น.ส.นิรมล มาระตา ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกชำนาญการ
 - 6.3 ว่าที่ ร.ต.วัชรระ โตเครือดี ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ